

活性型ビタミンD₃製剤劇薬 **フルスタン[®]錠0.15/0.3****PTPシート及びピローアルミ、
カートン仕様等変更のお知らせ**

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、活性型ビタミンD₃製剤『フルスタン[®]錠0.15/0.3』におきまして、PTPシート及びピローアルミ、カートン仕様等を変更いたしますのでご案内申し上げます。詳細につきましては下記をご参照ください。

お手数をおかけいたしますが、何卒、他の弊社製品共々、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹言

記

1 変更品弊社出荷予定時期について

製品	包装	統一商品コード	出荷時期	変更品初回製造番号
フルスタン [®] 錠0.15	100錠PTP	051632120	2019年11月頃	未定
フルスタン [®] 錠0.3	100錠PTP	051633127	2019年9月頃	2001C

※従来品の在庫が終了次第、出荷させていただきます。

※組成・性状・効能・効果、用法・用量、使用上の注意の変更はありません。


※統一商品コード、HOTコード、レセプト電算処理システムコード等、各種コードの変更はありません。

2 変更内容について


(1) PTPシート

- デザイン及びサイズを下記のとおり変更いたします。
- 製造番号の表示位置及び方法を、裏面上部への印字から表面上部への刻印に変更いたします。
- フルスタン®錠0.3について、バーコードの読み取り性向上を目的に裏面記載のバーコード表示を紫色から黒色へ変更いたします。

<フルスタン®錠0.15>

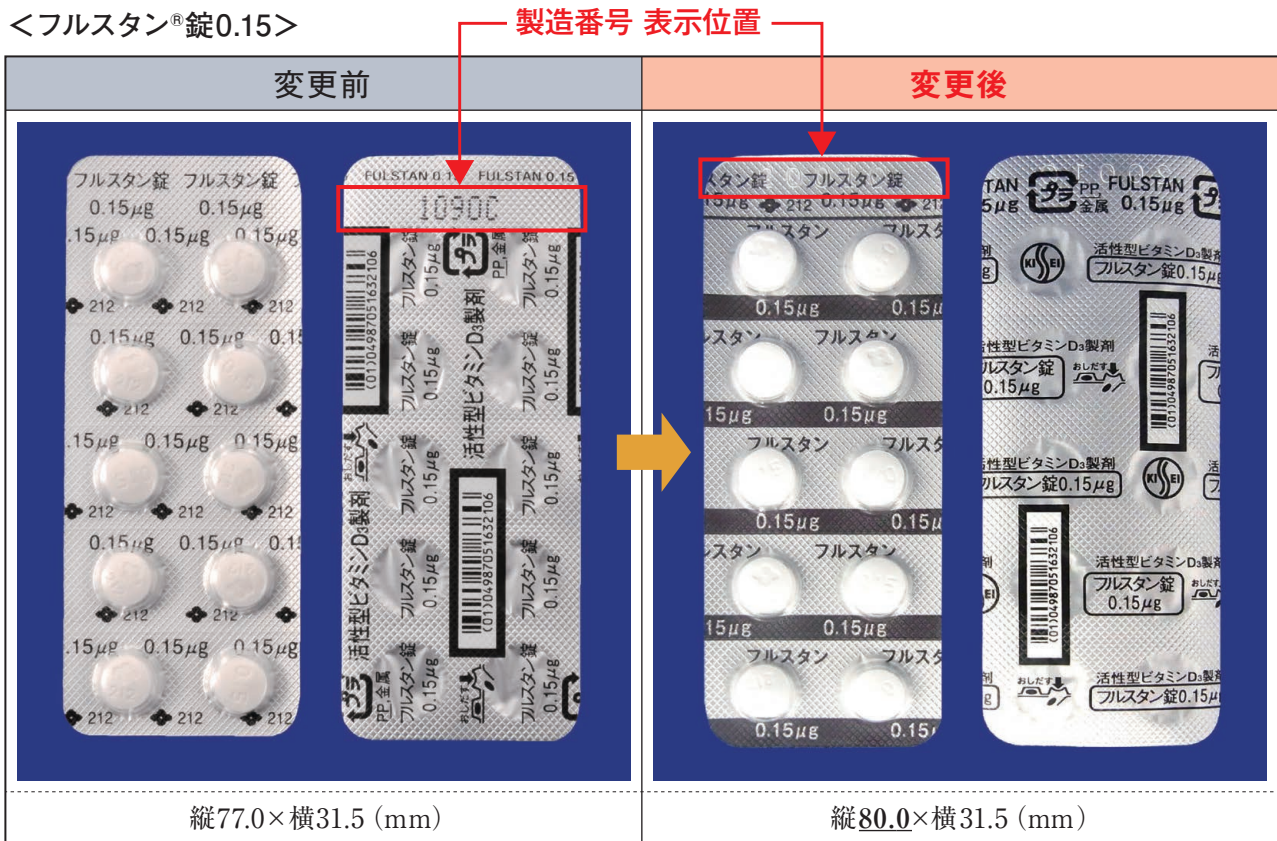


<フルスタン®錠0.3>

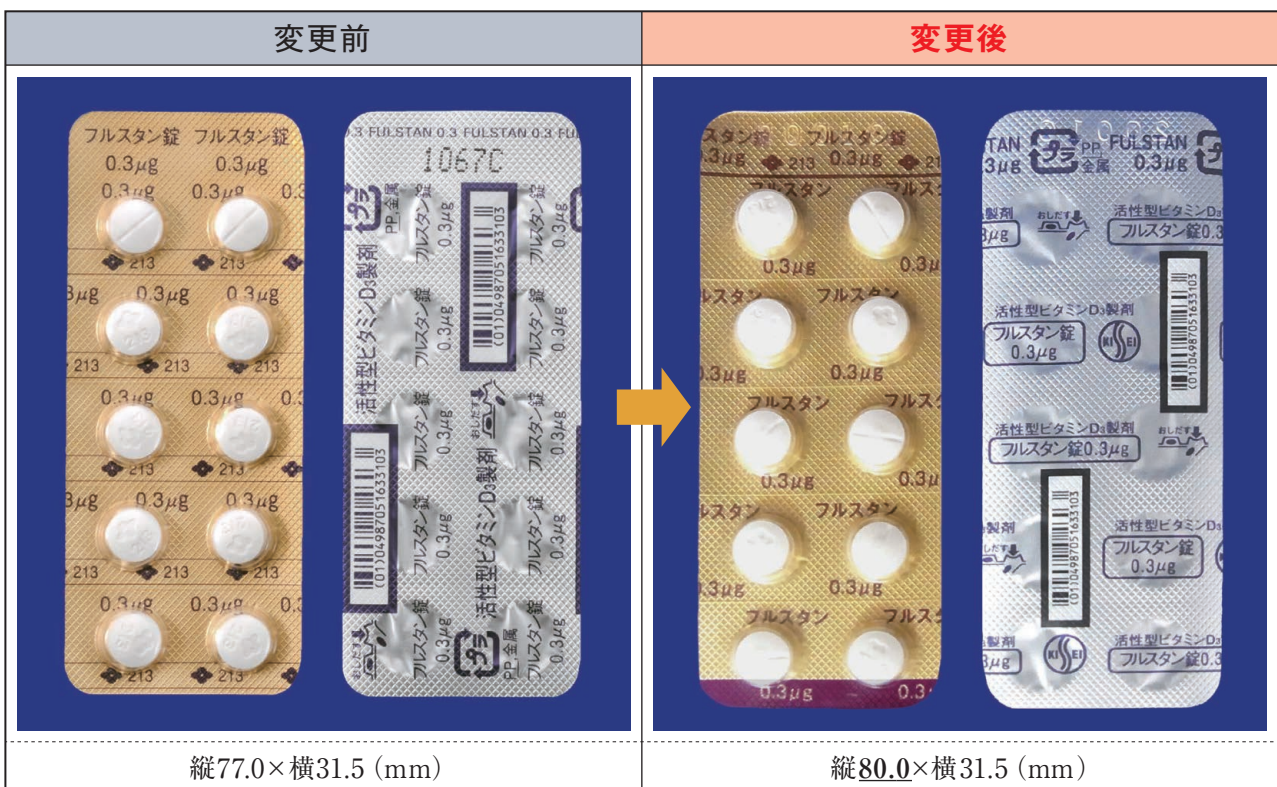

(2) ピローアルミ

「製品名」のみを表示したデザインから、「薬効分類名」「一般名」「調剤包装単位バーコード」「容量」「規格」の表示を追加したデザインへと変更いたします。

変更例：フルスタン[®]錠0.15

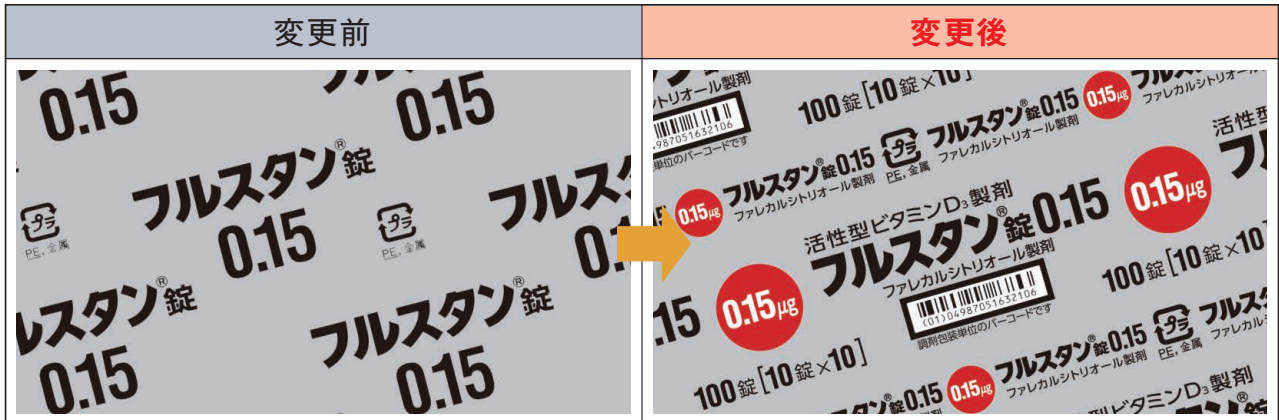

(3) カートン

<カートン形状・デザイン等>


- ・カートン形状を差込み方式から4枚フラップ方式へ変更し、封滅方法を封滅ラベルから接着方式（ホットメルト）へ変更いたします。
- ・規格間の識別性向上を目的に、カートンのデザインを下記のとおり変更いたします。
- ・捺印部分を黒地にし、上：使用期限、下：製造番号の記載順へ変更いたします。
- ・捺印部分について、ミシン目から切り取りカード化してお使いいただける仕様へ変更いたします。

製品	変更前	変更後
フルスタン [®] 錠 0.15	<p>幅110×奥行48×高さ31 (mm) 重量23 (g)</p>	<p>幅120×奥行48×高さ38 (mm) 重量38 (g)</p>
フルスタン [®] 錠 0.3	<p>幅110×奥行48×高さ31 (mm) 重量24 (g)</p>	<p>幅120×奥行48×高さ38 (mm) 重量38 (g)</p>

<遮光カード>

カートン開封口側のフラップ部分を、ミシン目で切り取って活用いただける「遮光カード」に変更いたします。フルスタン®錠は遮光保存のため、製剤保管時に引出し棚のインデックスに入れたり、ピローアルミに輪ゴムで添付したり等、必要に応じてご利用ください。

例：フルスタン®錠0.15 100錠カートン

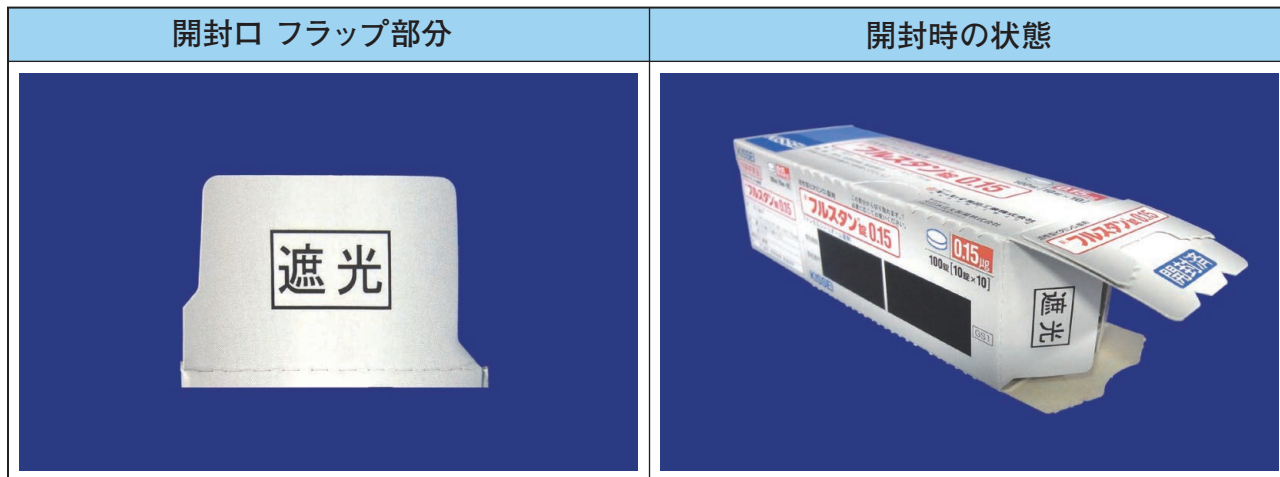


3 患者様向けお知らせカード、包装変更表示について

PTPシートが変更になりますので、対象製品において、変更の旨を患者様にお知らせいただけるよう、しばらくの間、患者様向けお知らせカードを封入いたします。

また、お手元に届いた製品が変更品であることをお知らせするため、しばらくの間、下記の変更表示をカートンに行います。

<患者様向けお知らせカード>



封入枚数 …… 10枚

<包装変更表示>

天面	捺印面
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> PTPシートデザイン、ピローデザイン、 カートンデザイン・形状変更品 </div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 包装変更品 </div>