

遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤

生物由来製品
 劇薬
 処方せん医薬品^{注)}

エポエチンアルファBS^注 750 1500 3000 シリンジ「JCR」

注) 注意-医師等の処方せんにより使用すること

カートン仕様変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤『エポエチンアルファBS^注シリンジ「JCR」』におきまして、カートンの側面部封緘方法、捺印方式等を変更いたしますのでご案内申し上げます。詳細につきましては下記をご参照ください。

お手数をお掛けいたしますが、何卒、他の弊社製品共々、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹言

記

1 変更品弊社出荷予定時期について

製品	包装	出荷時期	変更品初回製造番号
エポエチンアルファBS ^注 750シリンジ「JCR」	10シリンジ	2014年6月下旬	JSAK004
エポエチンアルファBS ^注 1500シリンジ「JCR」	10シリンジ	2014年6月下旬	JSBK005
エポエチンアルファBS ^注 3000シリンジ「JCR」	10シリンジ	2014年6月下旬	JSCK006

※従来品の在庫終了次第、包装ごとに出荷させていただきます。

※組成・性状・効能・効果、用法・用量、使用上の注意の変更はありません。


※JANコード、HOTコード、レセプト電算処理システム用コード等、各種コードの変更はありません。

2 変更内容について

(1) カートン側面部封緘方法等変更について

カートン側面形状を差込式から、4枚フラップ形状に変更し、封緘方法を封緘ラベルから接着方式(ホットメルト)へ変更いたします。カートンサイズに変更はありません。


＜変更例：エポエチンアルファBS^注3000シリンジ「JCR」 カートン写真＞

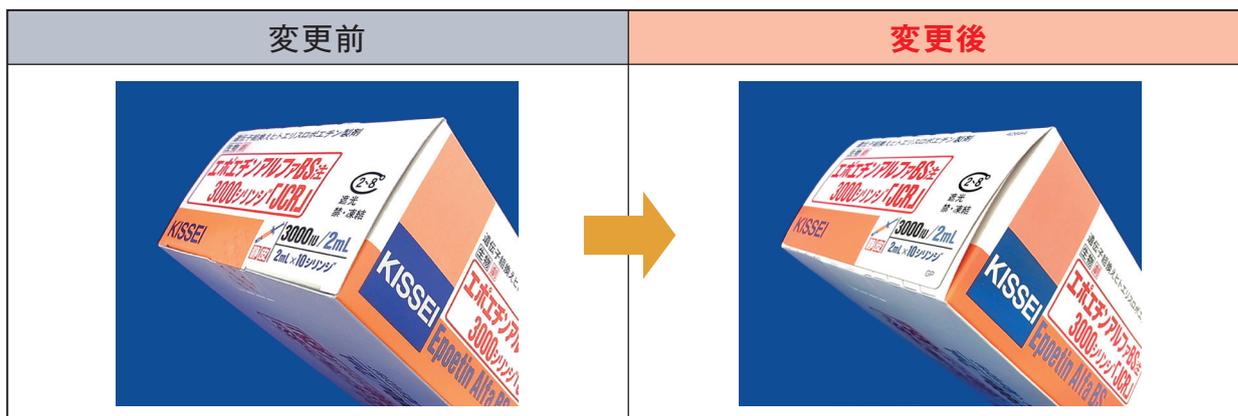

(2) 捺印方法変更について

製造番号、使用期限、GS1-DataBar (RSS) の表示部分について、捺印方法をラベル貼付からレーザー捺印へと変更いたします。

<変更例：エポエチナルファBS注3000シリンジ「JCR」 カートン写真>

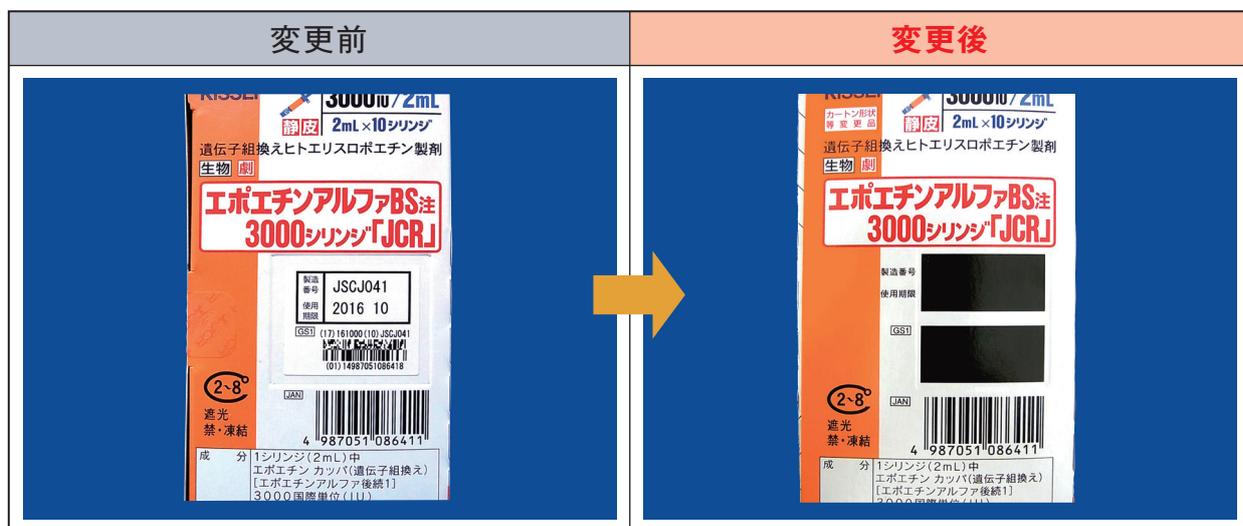

※変更後の写真については捺印前のものです。製品については黒枠内に白字でレーザー捺印されます。

3 包装変更表示について

お手元に届いた製品が変更品であることをお知らせするため、しばらくの間、下記の変更表示をカートンに行います。

